

Примечания:

1) все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или аттестации;

2) допускается применение других средств поверки, отличных от перечисленных, метрологические характеристики которых не хуже указанных.

3) Паяльная станция МАГИСТР Ц20 используется в качестве нагревателя насадки. Допускается использование иных нагревателей обеспечивающих стабилизацию температуры насадки в указанном диапазоне.

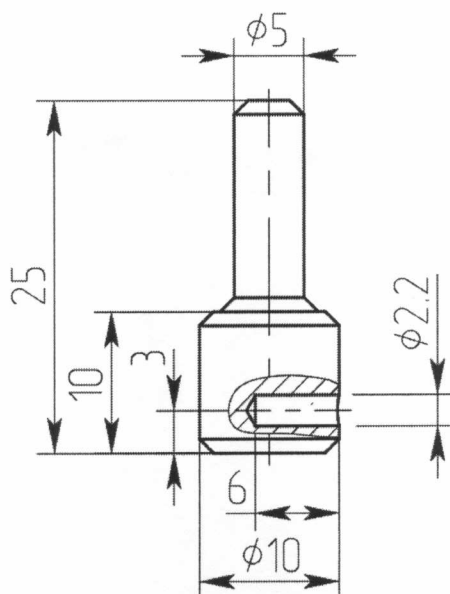


Рис. 1. Насадка

3 Условия поверки

3.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды $25 \pm 5^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха 45-80%;
- относительное давление от 84,0 до 106,7 кПа (от 630 до 800) мм рт.ст.

3.2 Средства поверки должны быть защищены от вибраций и ударов, от внешних магнитных и электрических полей.

4 Требования безопасности

4.1 При поверке выполняют требования техники безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на применяемые средства поверки.

4.2 К поверке допускают лиц имеющих необходимую квалификацию и обученных правилам техники безопасности и изучивших настоящую методику.

5 Подготовка к поверке

5.1 Средства поверки, подготавливаются в соответствии с эксплуатационной документацией.

5.2 Эталонные средства поверки устанавливаются на прочном горизонтальном основании исключающем вибрацию. Запрещается размещать средства поверки вблизи от нагревательных приборов.

5.3 Поверяемый прибор выдерживается при температуре поверки в течение 2 ч.

5.4 Подготавливают к работе проверяемый прибор в соответствии с его техническим описанием и руководством по эксплуатации.